Monnal T50 / T40

Guide rapide

www.airliquidemedicalsystems.com

Préparer

Allumer l'appareil

Appuyer sur le bouton au dos du ventilateur

Configurer le ventilateur

Pour une utilisation mono-branche : insérer le cache expiratoire

Pour une utilisation double branche : insérer la valve expiratoire

Afficher le VTe ou VTi à l'écran

Démarrer ou arrêter

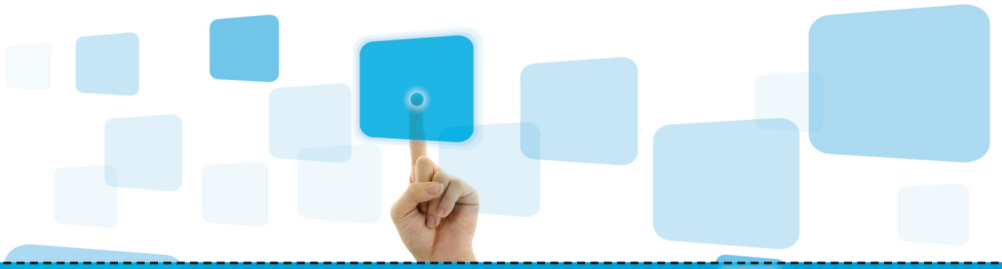

Eteindre le ventilateur

ECRAN HÔPITAL

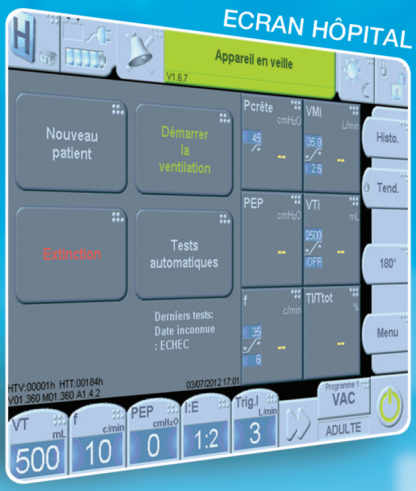

Démarrer/Arrêter le ventilateur

Eteindre le ventilateur

ECRAN PATIENT

Démarrer/Arrêter le ventilateur

Régler

Déverrouillage de l'écran

Maintenir l'icône cadenas
et la touche "Valider" simultanément

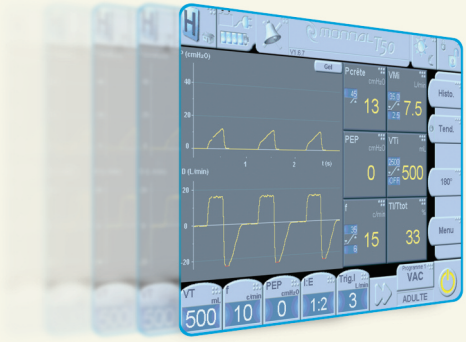

Ajuster un seuil d'alarme

Les seuils d'alarme sont indiqués dans chaque pavé de monitorage.

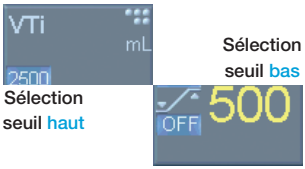

Sélection seuil haut

Sélection seuil bas

Un appui sur la moitié (haute ou basse) du pavé sélectionne le seuil d'alarme associé.

Modifier une consigne

Sélectionner



Ajuster

Valider

Volume cible

Le patient ne reçoit pas assez d'air



VT < Volume cible

Le patient reçoit trop d'air



VT > Volume cible

Exemple d'ajustement lorsque VT < Volume cible

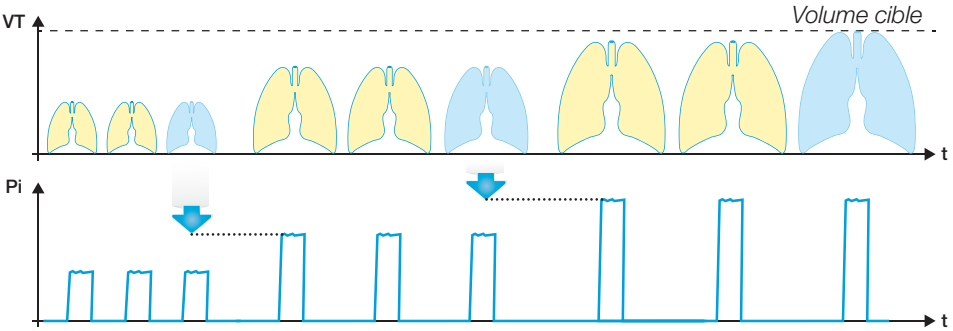

La PI est ajustée tous les **3 cycles** (en montée comme en descente).
La PI **varie** de 0,1cm à 3cmH20 selon **l'écart** entre VT et Volume cible.
Le Volume mesuré (VT) dépend de la configuration :

en **simple** branche, on mesure le **VTi.**

en **double** branche, on mesure le **VTe.**

Contact

Air Liquide Medical Systems
Parc de Haute Technologie
6, rue Georges Besse
92182 Antony Cedex, France
Fax : 01 40 96 67 00

Service client

0820 146 359
0,12€ TTC/mn
depuis un poste fixe

Le recyclage des équipements électriques permet de préserver les ressources naturelles et d'éviter tout risque de pollution. A cette fin, Air Liquide Medical Systems remplit ses obligations relatives à la fin de vie des dispositifs électro-médicaux que nous mettons sur le marché en adhérant et en finançant la filière de recyclage de Récylum. Récylum reprend auprès de nos clients nos dispositifs électro-médicaux en fin de vie.

Lire attentivement le manuel d'utilisation.
Fabriqué par Air Liquide Medical Systems SA.
Dispositif médical de classe IIb. CE 0459

YN040451 - Conception et Impression : Imprimerie Cres - © Crédits Photos Le Square et Imprimerie Cres

AIR LIQUIDE Healthcare

Air Liquide Healthcare est un leader mondial des gaz médicaux, de la santé à domicile, des produits d'hygiène et des ingrédients de spécialité santé. Il a pour mission de fournir à ses clients, tout au long du parcours de soins de l'hôpital au domicile, des produits médicaux, des ingrédients de spécialité et des services qui contribuent à protéger les vies vulnérables.